

# “華宇”主動式負壓導尿套(未滅菌) 中文說明書

## 型號:TrueClr Pediatric M(小兒男性)

### 步驟 1: 確認適合您的導尿套型號

1. 華宇主動式負壓導尿套Pediatric M(適用於小兒男性)。
2. 導尿套建議搭配使用的抽吸器幫浦:戴爾貝斯 DeVilbiss 抽吸器幫浦型號:7314P-D, 或是醫護中心牆面式抽吸裝置或是其它符合要求之抽吸裝置。
3. 醫用含碘棉棒(如有需要可使用)與手套(如有需要可使用)。

操作教學影片網址:

<https://vimeo.com/823874271?share=copy>

### 步驟 2: 準備

1. 使用肥皂與清水清洗雙手，穿戴個人的防護裝備像是手套(如有需要可使用)。
2. 將幼兒放在舒適、平坦的表面上。請勿讓幼兒獨自留在那裡。
3. 使用含碘棉棒清潔陰莖(包含包皮的下方，如果有的話)。
4. 調整抽吸器到最低的吸力。
5. 將主動式負壓導尿套遠端的管子連接到抽吸器幫浦的尿液收集瓶上。
6. 將抽吸器幫浦的電源打開。

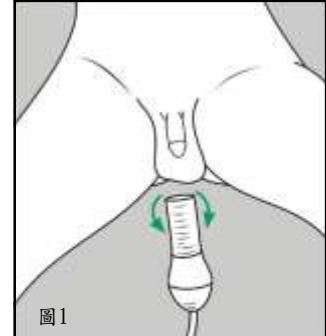


圖1

### 步驟 3: 穿戴

1. 將主動式負壓導尿套軟膠部分向外翻(如圖1)。
2. 用一隻手握好陰莖。
3. 使用另一隻手，將已翻好的主動式負壓導尿套套入陰莖，並將外翻的導尿套部分套回陰莖上，至少套住1英吋(約2.54公分)的陰莖(如圖2)。
4. 如果病患有包皮包覆陰莖，則導尿套至少需套住1.5英吋(約3.81公分)，
5. 調整抽吸器幫浦的吸力，調整到最適合的導尿效果與病患舒適度，請勿超過130毫米汞柱的壓力。
6. 吸引了一些時間後，尿液將開始透過負壓導尿被導流到集尿瓶中(如圖3)。

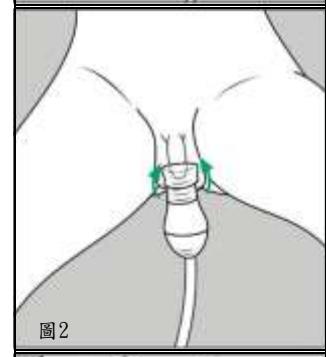


圖2

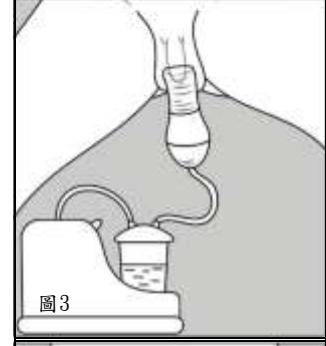


圖3

### 步驟 4: 移除

1. 當尿液不再導流出來時，請再等30秒鐘的時間。
2. 取下主動式負壓導尿套時，將手指插入導尿套和陰莖之間以創造一個空隙。小心地將導尿套從陰莖上拿下來(圖4)。
3. 關閉抽吸器幫浦的電源。
4. 使用後，務必清潔並乾燥病患與導尿套接觸的部位。
5. 記得記錄尿量、日期和時間。
6. 取下集尿瓶。按照生物安全和感染控制協議和標準處理尿液。
7. 使用肥皂和水清洗集尿瓶。
8. 使用肥皂和水清洗導尿套，然後晾乾。
9. 每4-6小時或根據您的醫療專業人員的建議排空膀胱。



圖4

### 問題處理

問題	可能的原因
吸力不足	<ul style="list-style-type: none"><li>• 集尿瓶蓋子沒有蓋緊</li><li>• 抽吸器幫浦吸力設定過低</li><li>• 管路沒有恰當的連接</li><li>• 管路彎折到，或是管路內堵塞</li></ul>

### 導尿套所有的零組件請作為感染性廢棄物處理

為避免交叉感染，請遵循您的醫療機構制定的感染控制政策。

暴露於極端高溫或低溫可能會影響導尿套的顏色，但不會影響其功能。

患者洗澡時請勿使用。在使用過程中請勿將其掉入水中或其他液體中。

導尿套所有零組件均不含乳膠。

保存條件: 5°C~34°C 保存。

建議連續穿戴兩天後清洗產品一次，醫院使用建議15天後更換新品，居家使用建議30天後更換新品。

**適應症:** 華宇主動式負壓導尿套旨在用於小兒男性的非侵入性尿液收集管理。

醫療器材商名稱: 華宇藥品股份有限公司

醫療器材商地址: 臺北市中山區中山北路2段115巷43號8樓

製造業者名稱: DemeTech Corporation

製造業者地址: 5980 Miami Lakes Dr, Miami Lakes, FL 33014, United States of America

衛部醫器輸壹字第023470號

製造批號: 請見原文包裝標示

製造日期：請見原文包裝標示